

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-simei-ultra150-ze-stojakiem-pneumatycznym-p-207.html>



Lampa LED SIMEI ULTRA150 ze stojakiem pneumatycznym

Cena

4 668,10 zł

Kod producenta

ZES_RDPRO750FS7_PS

Opis produktu

Kompaktowa lampa z płynną regulacją wysokości – precyzyjne sesje na twarz i wybrane partie

Zestaw łączy lampę LED **ULTRA150** z dedykowanym stojakiem pneumatycznym **SIMEI PS**. Dostajesz komplet gotowy do sesji – panel ustawisz na dowolnej wysokości w zakresie **97,5-136 cm**, pionowo albo poziomo – bez wieszania na drzwiach i bez wiercenia. W zestawie płacisz mniej niż za oba produkty kupione osobno.

ULTRA150 to **150 diod Dual Chip, 7 długości fal (480-1060 nm)** i natężenie **78,4 mW/cm² z 15 cm w pomiarze laboratoryjnym** (solarmetrem ok. 120 mW/cm²) na panelu 47,3 × 30 cm – w jednej sesji naświetlisz twarz, szyję i dekolty albo wybrane partie ciała. Gwarancja door-to-door: **3 lata na lampę i 2 lata na stojak**, serwis w Polsce.

7 fal

480-1060 nm

78,4 mW/cm²

natężenie z 15 cm (laboratorium)

97,5-136 cm

regulacja wysokości

pion / poziom

pozycja panelu





3 lata gwarancji na lampę

Stojak 2 lata. Door-to-door – odbieramy i odsyłamy na nasz koszt



Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju



Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montażu i ustawieniu: 533-101-668



Certyfikaty CE i RoHS, IEC, FCC

Producent z certyfikatem ISO 13485 i rejestracją FDA



Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres



14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety zestawu


Lampa odpowiada za światło, stojak za wygodę: ustawisz panel dokładnie na wysokości partii ciała, którą chcesz naświetlić, i zmienisz jego pozycję między sesjami. W paczce z lampą jest też **hak na drzwi i linki**, więc gdy zechcesz, zawieszisz ją także bez stojaka. Jak działa terapia światłem czerwonym, opisujemy szczegółowo na [karcie lampy SIMEI ULTRA150 →](#)

480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm · 78,4 mW/cm² z 15 cm (laboratorium)

Pełne spektrum 7 fal w kompaktowym panelu

Na powierzchni zaledwie **47,3 × 30 cm** ULTRA150 mieści **150 diod Dual Chip** i 7 długości fal: niebieskie **480 nm** działa w naskórku, czerwone **630 i 660 nm** w skórze, a bliska podczerwień **810, 830, 850 i 1060 nm** wnika głębiej.

Natężenie zmierzone w laboratorium spektrometrem wynosi **78,4 mW/cm² z 15 cm** (solarmetrem ok. 120 mW/cm²), a każdą grupę fal regulujesz niezależnie w zakresie 0–100%. Z odległości 30 cm panel obejmuje ok. **63 × 46 cm** – twarz z szyją i dekoltem albo wybraną partię ciała.

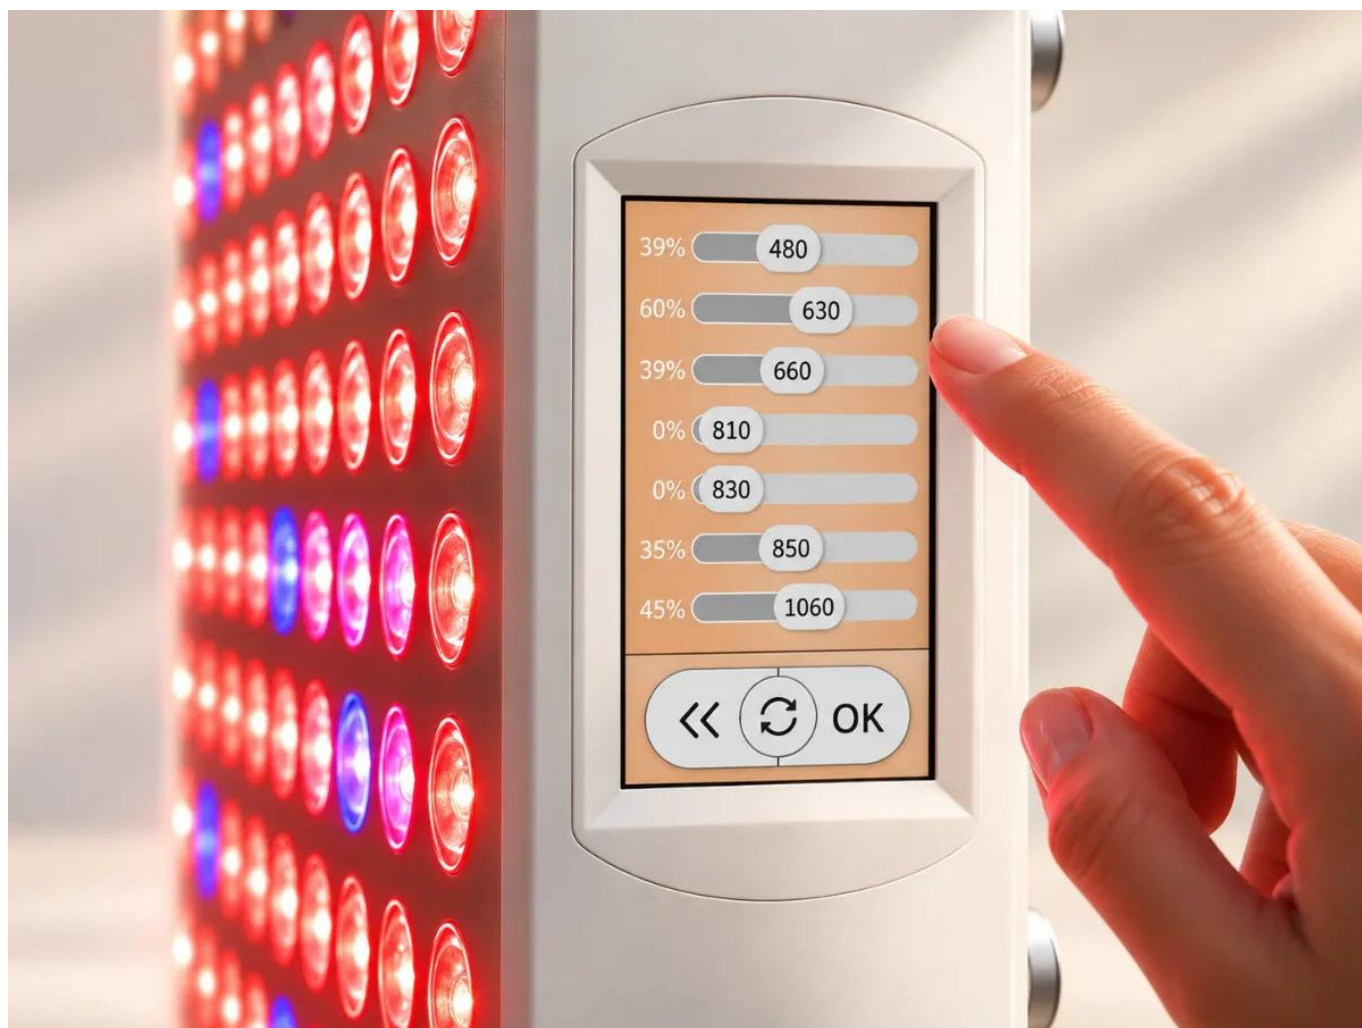


11 programów Smart · tryb Custom · pulsacja 0-128 Hz

Gotowe programy albo pełna kontrola

Wybierasz jeden z **11 programów Smart** albo zapisujesz własne ustawienia w trybie **Custom**: jasność 0-100% dla każdej fali, timer 1-30 minut i pulsację bliskiej podczerwieni 0-128 Hz.

Sterujesz z **ekranu dotykowego**, **pilotem** albo z **aplikacji mobilnej**. Otwarta konstrukcja bez szklanej osłony, 2 wentylatory i żywotność diod szacowana przez producenta na **50 000 godzin**.

Masz więcej niż jedną lampę? Każdy panel przypiszesz do jednej z 3 grup i sterujesz całą grupą naraz – z pilota albo z aplikacji. Kilka lamp włączysz jednym przyciskiem, z tymi samymi ustawieniami. W zestawie jest też kabel krosowy: połączysz nim kilka paneli w jeden większy zestaw, np. dwie lampy obok siebie, gdy zechcesz naświetlać większą powierzchnię.

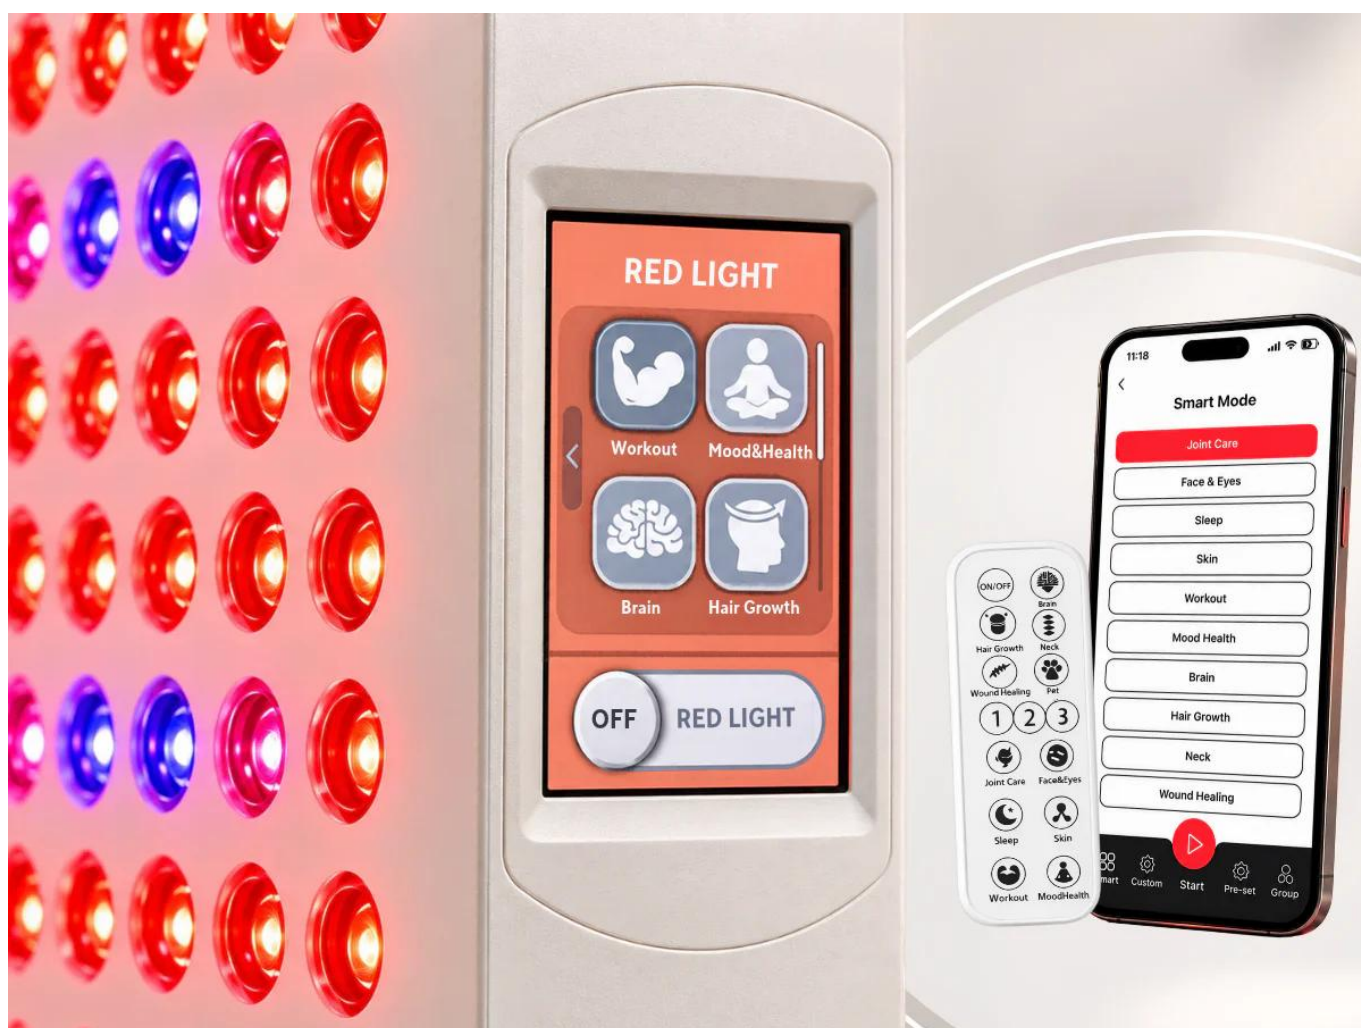

Siłownik pneumatyczny · 97,5-136 cm

Płynna regulacja wysokości bez wysiłku

Zintegrowany **siłownik pneumatyczny** zmienia wysokość płynnie i cicho – bez skoków, blokad i dokręcania śrub. Zakres **97,5-136 cm** pozwala dopasować panel do wzrostu użytkownika i rodzaju sesji: na stojąco, na krześle albo przy kozetce.



Pion · poziom · stal + aluminium

Pion albo poziom - sesje na stojąco, siedząco i na leżąco

Na stojaku panel pracuje w dwóch pozycjach: **pionowo** - na stojąco lub siedząco, oraz **poziomo** - nad kozetką, łóżkiem albo matą, np. na plecy, brzuch czy nogi.

Rama ze **stali** z elementami z **aluminium** i szeroka podstawa **63,5 × 41 cm** zapewniają stabilność. Udźwig **do 23 kg** wystarcza dla lampy SIMEI ULTRA150 (5,7 kg), a sam stojak waży 10 kg, więc łatwo przestawić go w inne miejsce.



Natężenie zmierzone w niezależnym laboratorium

Większość sprzedawców lamp LED podaje natężenie z solarmetru albo z katalogu producenta. My zleciliśmy pomiar lampy z serii ULTRA w niezależnym laboratorium optycznym. Lampę zmierzono **profesjonalnym spektrometrem** przy wszystkich długościach fal ustawionych na 100%. Modele z serii ULTRA mają te same diody i różnią się tylko ich liczbą, więc natężenie na cm^2 jest w nich takie samo.

78,4 mW/cm^2

z 15 cm

63,2 mW/cm^2

z 30 cm

54,3 mW/cm^2

z 45 cm

2,3%


migotanie w trybie ciągłym

Popularny solarmetr pokazuje przy tej samej lampie z 15 cm ok. 120 mW/cm^2 . To typowe zawyżenie: solarmetr jest skalibrowany pod szerokie widmo słońca, a diody LED świecą wąskimi pasmami, dlatego większość sprzedawców podaje natężenie wyższe od rzeczywistego. Spektrometr mierzy każdą długość fali osobno. Podajemy oba wyniki, ale do porównań uczciwszy jest pomiar laboratoryjny.

Deklaracje typu „moc diod 5 W” albo natężenie bez podanej odległości nic nie mówią o dawce, którą otrzymuje skóra – dlatego przy każdym wyniku podajemy odległość pomiaru.

Natężenie lamp FS7: solarmetr a laboratorium

mW/cm², wszystkie długości fal na 100%

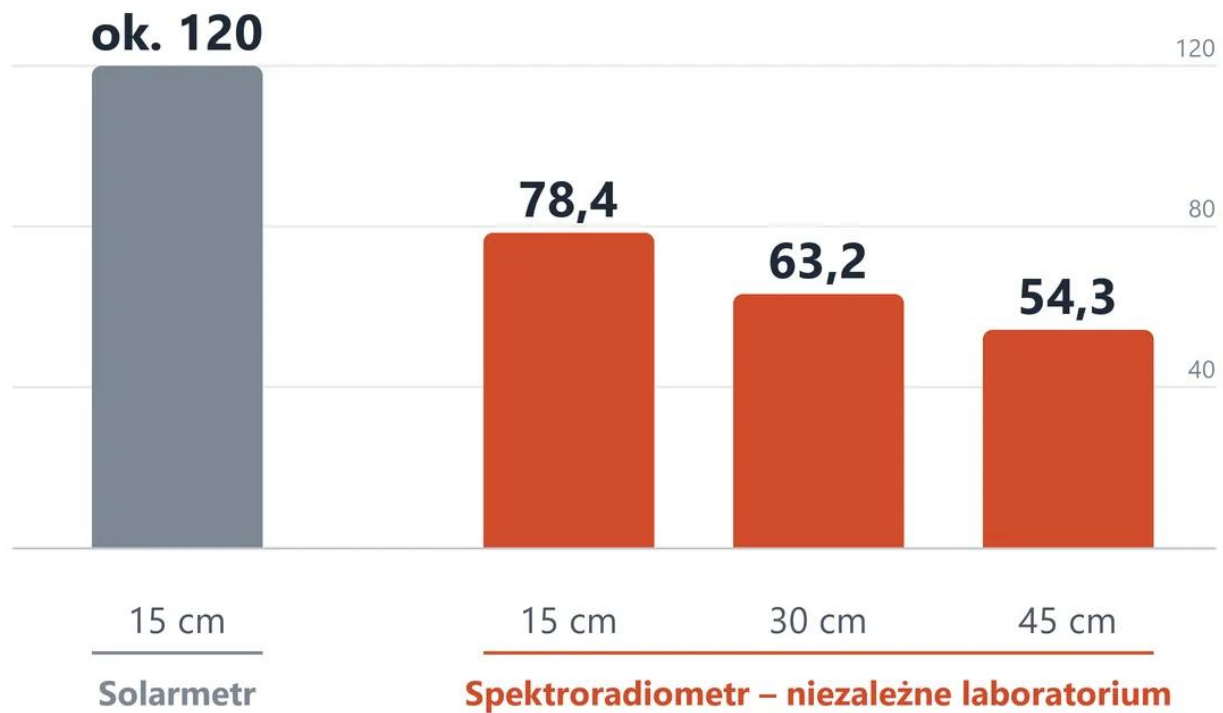

Jaki obszar ciała naświetli lampa?

Panel ma wymiary **47,3 x 30 cm**, a diody świecą pod kątem **30°**. Im dalej od lampy jesteś, tym większy obszar obejmuje światło – ale tym niższe jest jego natężenie. Na stojaku pneumatycznym odległość i wysokość ustawisz pod każdą sesję, także na leżąco.

15 cm

obszar ok. **55 x 38 cm**

Najwyższe natężenie – precyzyjna sesja na wybraną partię: klatkę piersiową, kark, bark lub kolano

30 cm

obszar ok. **63 x 46 cm**

Uniwersalna odległość – tułów albo plecy; po przestawieniu lampy także twarz z dekoltem

90 cm

obszar ok. **95 x 78 cm**

Większy obszar – od głowy do bioder; łagodniejsze światło, dłuższa sesja

Wymiary obszaru wyliczone geometrycznie z wielkości panelu i kąta świecenia 30° dla lampy ustawionej pionowo (przy pozycji poziomej wysokość i szerokość się zamieniają). Natężenie zmierzone w laboratorium spektrometrem wynosi 78,4 mW/cm² z 15 cm, 63,2 mW/cm² z 30 cm i 54,3 mW/cm² z 45 cm (solarmetrem z 15 cm ok. 120 mW/cm²) – z większej odległości jest niższe, dlatego sesję warto odpowiednio wydłużyć.

Jak to działa

1

Zamocuj lampę na stojaku

Zamocuj panel na stojaku – śruby i adaptory są w zestawie montażowym stojaka.

2

Ustaw stojak

Siłownikiem ustaw wysokość, wybierz pozycję pionową lub poziomą i zajmij miejsce ok. 15–30 cm od panelu. Załóż okulary ochronne z zestawu.

3

Rozpocznij sesję

Na ekranie, pilotem lub w aplikacji wybierz jeden z 11 programów Smart albo własne ustawienia w trybie Custom. Typowa sesja trwa 10–20 minut, a lampa wyłączy się sama.

Chcesz porównać parametry lampy SIMEI ULTRA150 z innymi modelami albo przekazać je w gabinecie? [Pobierz kartę lampy w PDF →](#)

Który wariant wybrać

Parametr	ULTRA150 + SIMEI PS na stojaku, bez wiercenia	ULTRA150 + SIMEI FS na podłodze, stole lub biurku, bez wiercenia	sama lampa SIMEI ULTRA150 na drzwiach (hak w zestawie)
Mocowanie lampy			
Regulacja wysokości	płynna, 97,5-136 cm	brak – panel stoi na podstawie	zależy od miejsca zawieszenia
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma	pionowa	pionowa lub pozioma (na linkach)
Sesje na leżąco	tak – panel nad kozetką lub łóżkiem	nie	tak, przy zawieszeniu poziomym
Przestawianie	stojak 10 kg, podstawa 63,5 × 41 cm	stojak 2 kg, kółka z blokadą	przewieszasz lampę
Udźwig stojaka	do 23 kg	do 15 kg	—
Najlepiej do	gabinet, studio, dom – różne rodzaje sesji	sesje na siedząco przy fotelu, łóżku lub biurku	dom, gdy wystarczy zawieszenie na drzwiach
Cena	ta karta	zobacz zestaw →	zobacz lampę →

Szukasz innej lampy albo innego zestawu? [Zobacz wszystkie lampy LED do terapii światłem →](#)

Dlaczego warto kupić u nas

	Zestaw ULTRA150 + SIMEI PS w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Natężenie światła	✓ 78,4 mW/cm ² z 15 cm zmierzone w niezależnym laboratorium (solarmetrem ok. 120 mW/cm ²)	„moc diod” lub natężenie bez odległości i bez pomiaru laboratoryjnego
Dobry stojak	✓ Stojak pneumatyczny SIMEI PS przeznaczony do ULTRA150, udźwig 23 kg przy lampie 5,7 kg	stojak „uniwersalny” bez podanego udźwigu i listy lamp
Cena zestawu	✓ taniej niż lampa i stojak kupione osobno	akcesoria dokupowane osobno, często u innego sprzedawcy
Certyfikaty	✓ CE i RoHS, IEC, FCC; producent z ISO 13485 i rejestracją FDA	często brak dokumentów lub CE bez deklaracji zgodności
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer i podmiot odpowiedzialny w UE	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 36 mies. door-to-door na lampę i 24 mies. na stojak, serwis w Polsce	często brak gwarancji lub naprawa za granicą
Wsparcie techniczne	✓ instrukcje PL i doradca pod 533-101-668 – także przy montażu stojaka	kontakt przez formularz lub chat

Dla kogo jest zestaw ULTRA150 ze stojakiem

Dobry wybór

Ten zestaw sprawdzi się, jeśli:

- naświetlasz twarz, szyję albo wybrane partie i chcesz ustawić panel dokładnie na ich wysokości (97,5-136 cm),
- prowadzisz sesje na leżąco – panel ustawisz poziomo nad kozetką albo łóżkiem,
- pracujesz w gabinecie i szybko ustawiasz lampę pod każdego klienta,
- chcesz 7 długości fal z regulacją 0-100% i 11 programów Smart.

Inna potrzeba

Rozważ inny wariant, jeśli:

- wystarczy Ci lampa w pionie przy fotelu albo na biurku → [ULTRA150 ze stojakiem podłogowym](#),
- chcesz w jednej sesji naświetlać tułów albo całe plecy → [ULTRA300 ze stojakiem pneumatycznym](#),
- chcesz naświetlać całą sylwetkę naraz → [ULTRA600 ze stojakiem pneumatycznym](#).

Co jest w zestawie

Lampa

Lampa LED SIMEI ULTRA150

- Lampa LED SIMEI ULTRA150
- 1x okulary ochronne
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x hak na drzwi
- zestaw do zawieszania (linki i zatrzaski)
- 1x kabel zasilający
- 1x kabel krosowy do łączenia paneli
- polska instrukcja obsługi

Stojak

Stojak pneumatyczny SIMEI PS

- Stojak pneumatyczny SIMEI PS
- zestaw montażowy (śruby i adaptory do paneli)
- instrukcja montażu i obsługi

Uwaga: chroń oczy przed intensywnym światłem

Podczas korzystania z zestawu zachowaj szczególną ostrożność:

- Zawsze zakładaj okulary ochronne z zestawu i nie patrz bezpośrednio w diody
- Nie przekraczaj udźwigu stojaka 23 kg i przed każdą sesją sprawdź, czy panel jest prawidłowo zamocowany
- Nie zasłaniaj wentylatorów i nie używaj lampy w temperaturze powyżej zalecanego zakresu
- W ciąży, przy padaczce fotogennej lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło skonsultuj stosowanie z lekarzem

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu (karty GPSR, PDF): [lampa LED](#) → · [stojak](#) →

Ważna informacja: lampa SIMEI ULTRA150 nie jest urządzeniem medycznym i nie została zaprojektowana ani przeznaczona do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania światła czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Specyfikacja

Zestaw

Typ

Lampa

Stojak

Lampa – parametry światła

Liczba diod LED

Długości fal

Irradiancja (pomiar solarmetrem)

Irradiancja (pomiar laboratoryjny spektrometrem)

Kąt wiązki światła

Lampa – funkcje i sterowanie

Tryb Smart

Tryb Custom

Regulacja intensywności

Timer

Pulsacja (NIR)

Sterowanie

Lampa – parametry techniczne

Żywotność diod

Pobór mocy

Zasilanie

Wentylatory

Zalecana temperatura otoczenia

Wymiary (S×W×G)

Masa

Emisja EMF

Migotanie

Stojak

Model

Regulacja wysokości

Pozycja panelu

Udźwig

Materiał

Wymiary (S×G×W)

Masa

Zakres temperatury pracy

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty lampy

Certyfikaty zakładu produkcyjnego

Zakup i wsparcie

Skład zestawu

Gwarancja

Producent i bezpieczeństwo

Marka

Producent

Deklaracja zgodności UE (lampa)

Bezpieczeństwo

Zestaw: lampa LED do fotobiomodulacji + stojak

[ULTRA150](#)

[Stojak pneumatyczny SIMEI PS](#)

150 (Dual Chip)

480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm

ok. 120 mW/cm² przy 15 cm

78,4 mW/cm² przy 15 cm

30°

tak (11 programów)

tak – zapis własnych ustawień

0-100% (dla każdej fali)

1-30 min

0-128 Hz

panel dotykowy, pilot, aplikacja mobilna

50 000 h

219 W

230 V / 50 Hz

2

10°C do 30°C

30 × 47,3 × 6,6 cm

5,7 kg

Znikoma

Niskie

SIMEI PS

97,5-136 cm (siłownik pneumatyczny)

pionowa lub pozioma

do 23 kg

stal, aluminium

63,5 × 41 × 97,5-136 cm

10 kg

-10°C do 40°C

[CE i RoHS](#), [IEC](#), [FCC](#)

ISO 13485 i MDSAP, rejestracja FDA

Lampa LED SIMEI ULTRA150, 1x okulary ochronne, 1x pilot zdalnego sterowania, 1x hak na drzwi, zestaw do zawieszania (linki i zatrzaski), 1x kabel zasilający, 1x kabel krosowy do łączenia paneli, polska instrukcja obsługi, Stojak pneumatyczny SIMEI PS, zestaw montażowy (śruby i adaptory do paneli), instrukcja montażu i obsługi
36 miesięcy na lampę, 24 miesiące na stojak (door-to-door)

SIMEI

HHO sp. z o.o.

ul. Stanisława Klimeckiego 8/75

30-705 Kraków

NIP: 6772490786

e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl

[DZ/2026/K/02 \(PDF\)](#)

[GPSR lampy](#), [GPSR stojaka](#)